



会社概要

お問い合わせ

緊急時、およびサポート時間など

機能紹介・導入事例

faq009.レジン前装（臼歯）を算定する場合に使う処置セット

▶ faq009.レジン前装（臼歯）を算定する場合に使う処置セット

※ このアップデートはCドライブWindows専用となります。

もし、お使いのパソコンが通常とは違ってCドライブから起動をしないPCの場合はご連絡をお願いします。

開く → [PDFをダウンロード]


クリック ➔ レジン前装、+接着材料 I のダウンロード ([SyotiSet_no009a.exe](#))

クリック ➔ "、+接着材料 II のダウンロード ([SyotiSet_no009b.exe](#))

クリック ➔ "、+接着材料III のダウンロード ([SyotiSet_no009c.exe](#))

↑

上記のファイルをダウンロードいただくと、レジン前装（臼歯）を算定するための専用処置セットファイルを、Win用でexe形式圧縮したものが取得できます。ダウンロードしたexe圧縮ファイルをお使いなされているレセコン用PC（親機）パソコンのデスクトップ等にコピー保存をされて、レセコンを終了している状態で、この圧縮アップデートで実行して下さい。

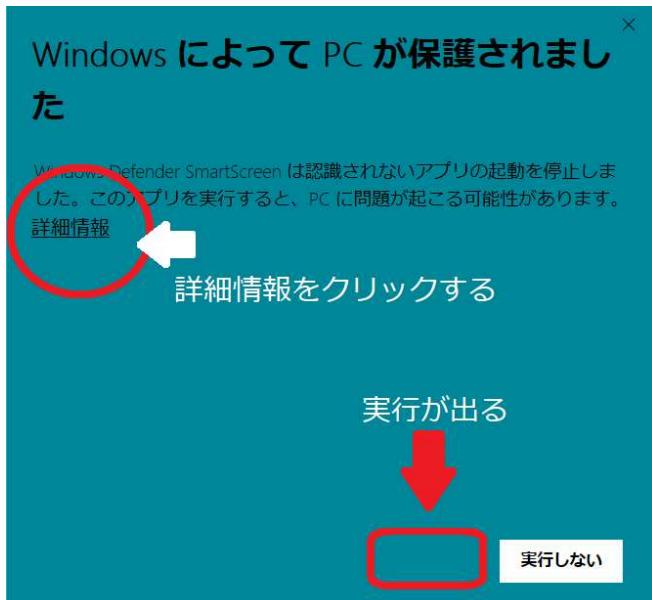

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmd.exe -u update_master\update_inst... -

.\update_master\files\038_syoti_set_master.TXT
\update_master\files\040_syoti_set_byomei.TXT
\update_master\files\041_syoti_set_detail.TXT
\update_master\files\処置セット_info.TXT

4 個のファイルをコピーしました。
レセコンフォルダへ所定ファイルを組込。

↓
↓
新しいマスク情報を組み致しました！
現在表示されている黒いウィンドウは
右上の「×」で閉じて下さい。
その後、レセコンを起動されて下さい。

正常に処理は終了しました！

続行するには何かキーを押してください . . . -

- ※ その際、Windowsが、「発行元が不明」などの警告アラートを出す場合がありますが、「実行」して下さい。
 - ※ 実行のボタンが隠れてる場合は、詳細情報...を見るなどされて、「実行」として下さい。アップデートは無事に終わり、上の黒い画面「正常に終了」ができましたら、赤いマーク色の右上「x」をクリックして閉じて下さい。

1. レセコンを起動してください。業務選択から「[F5]設定1」をクリックします。




2. 左上の「処置セット編集[07]」を、クリックします。




3. ○囲みの「外部セットの取り込み」をクリックします。



4. インポートしますか？が出ますので、「はい」をクリックします。

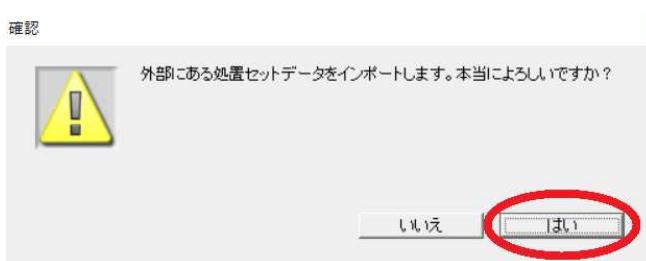

5. 識別IDを指定しますか？の質問では「いいえ」を選びます。

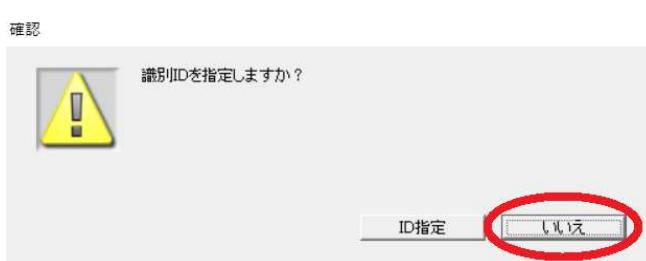

6. レジン前装（臼歯）を使う装着パターンが取り込みがされます。

7. 画面の右下にある「戻る」をクリックします。

内容から検索	病名から検索	選択項目を外部書出	戻る
内容と病名から検索	外部セットの取り込み		

8.

以上で、レジン前装（臼歯）の処置セットが取り込み完了いたしました。

前歯部3～3のみ範囲においては、 ここでレジン前装（臼歯）処置セットは利用できませんので、その点はご注意ください。

株式会社 デンタルハート

電子カルテレセプト・システム 歯科用販売